

# 医疗器械通用 名称命名指导 原则

单击此处添加副标题

汇报人：XXX

# 目录

CONTENTS


01. 通用名称的构成
02. 命名原则
03. 命名方法
04. 命名注意事项
05. 通用名称的审核与监督

01



# 通用名称的构成

章节副标题

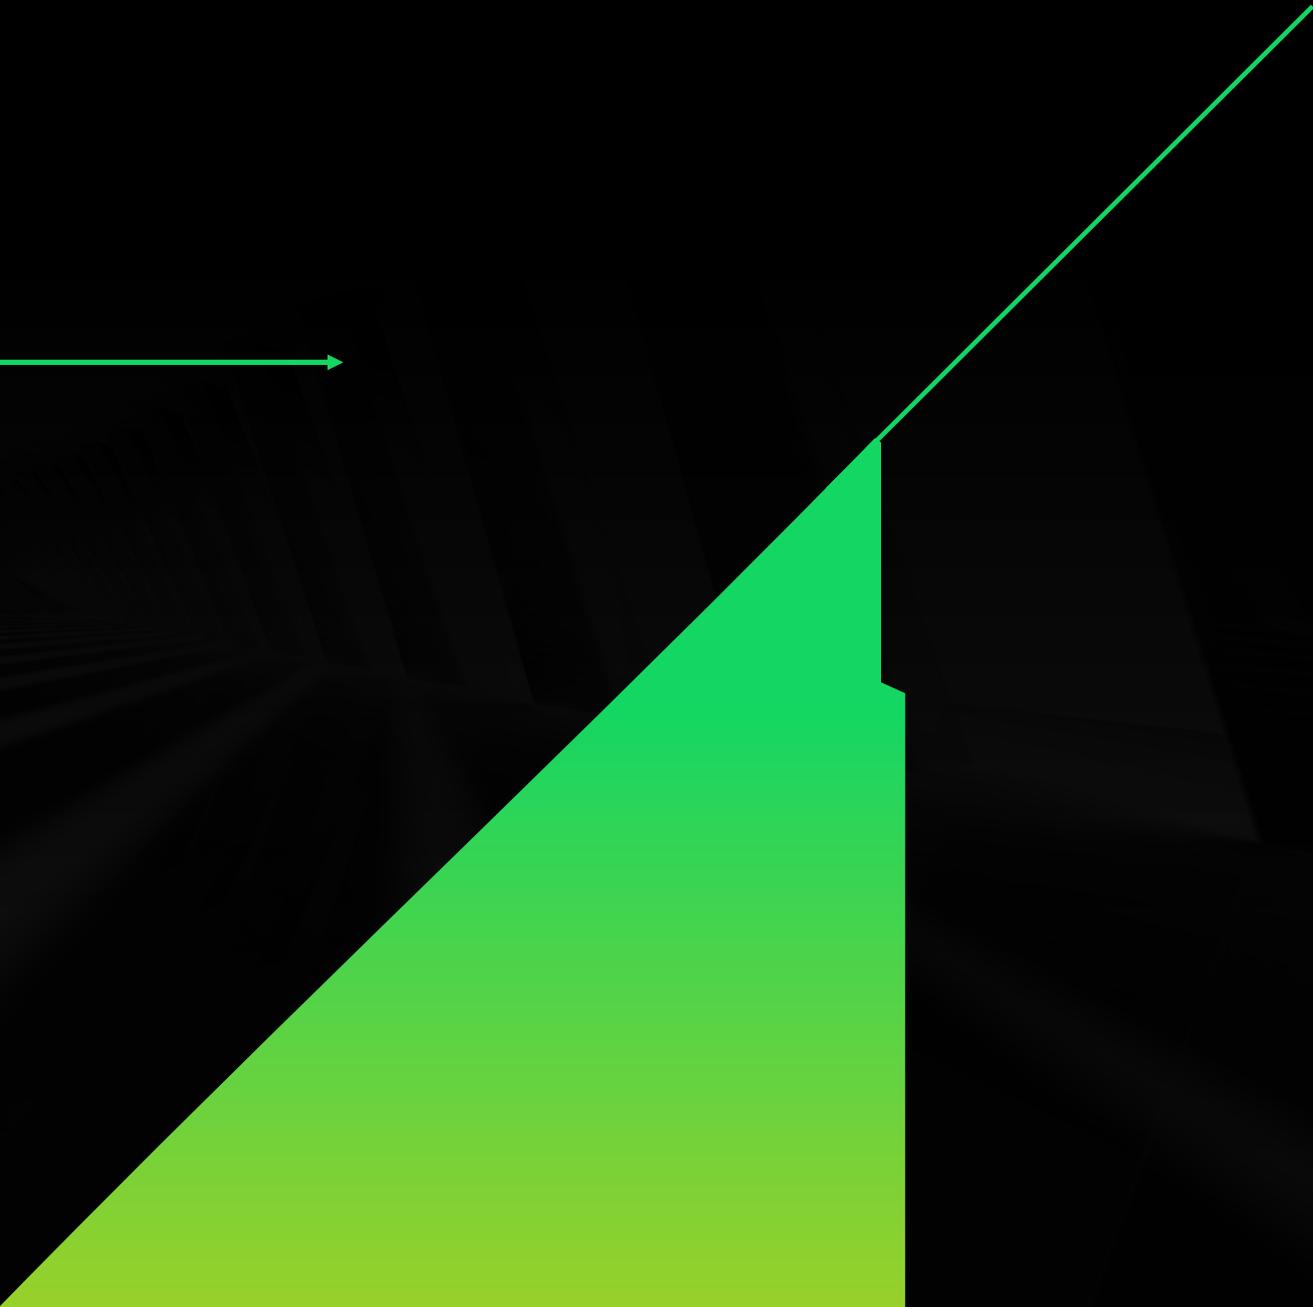

# 基本要素

---

医疗器械名称：应准确、简洁、易于识别

医疗器械类别：应明确医疗器械的类别和用途

医疗器械型号：应明确医疗器械的型号和规格

医疗器械生产厂家：应明确医疗器械的生产厂家和地址

# 限定词

通用名称的构成：由一个或多个限定词组成

限定词的选择：根据医疗器械的特点和用途进行选择

添加标题

添加标题

添加标题

添加标题

限定词的作用：限定医疗器械的用途、性能、材料等特征

限定词的使用：在通用名称中，限定词应准确、简洁、易于理解

# 修饰词

描述性修饰词：如“可调式”、“一次性”等

规格性修饰词：如“大号”、“小号”等

功能性修饰词：如“止血”、“止痛”等

形状性修饰词：如“圆形”、“方形”等

材料性修饰词：如“不锈钢”、“聚丙烯”等


颜色性修饰词：如“红色”、“蓝色”等

02



# 命名原则

章节副标题

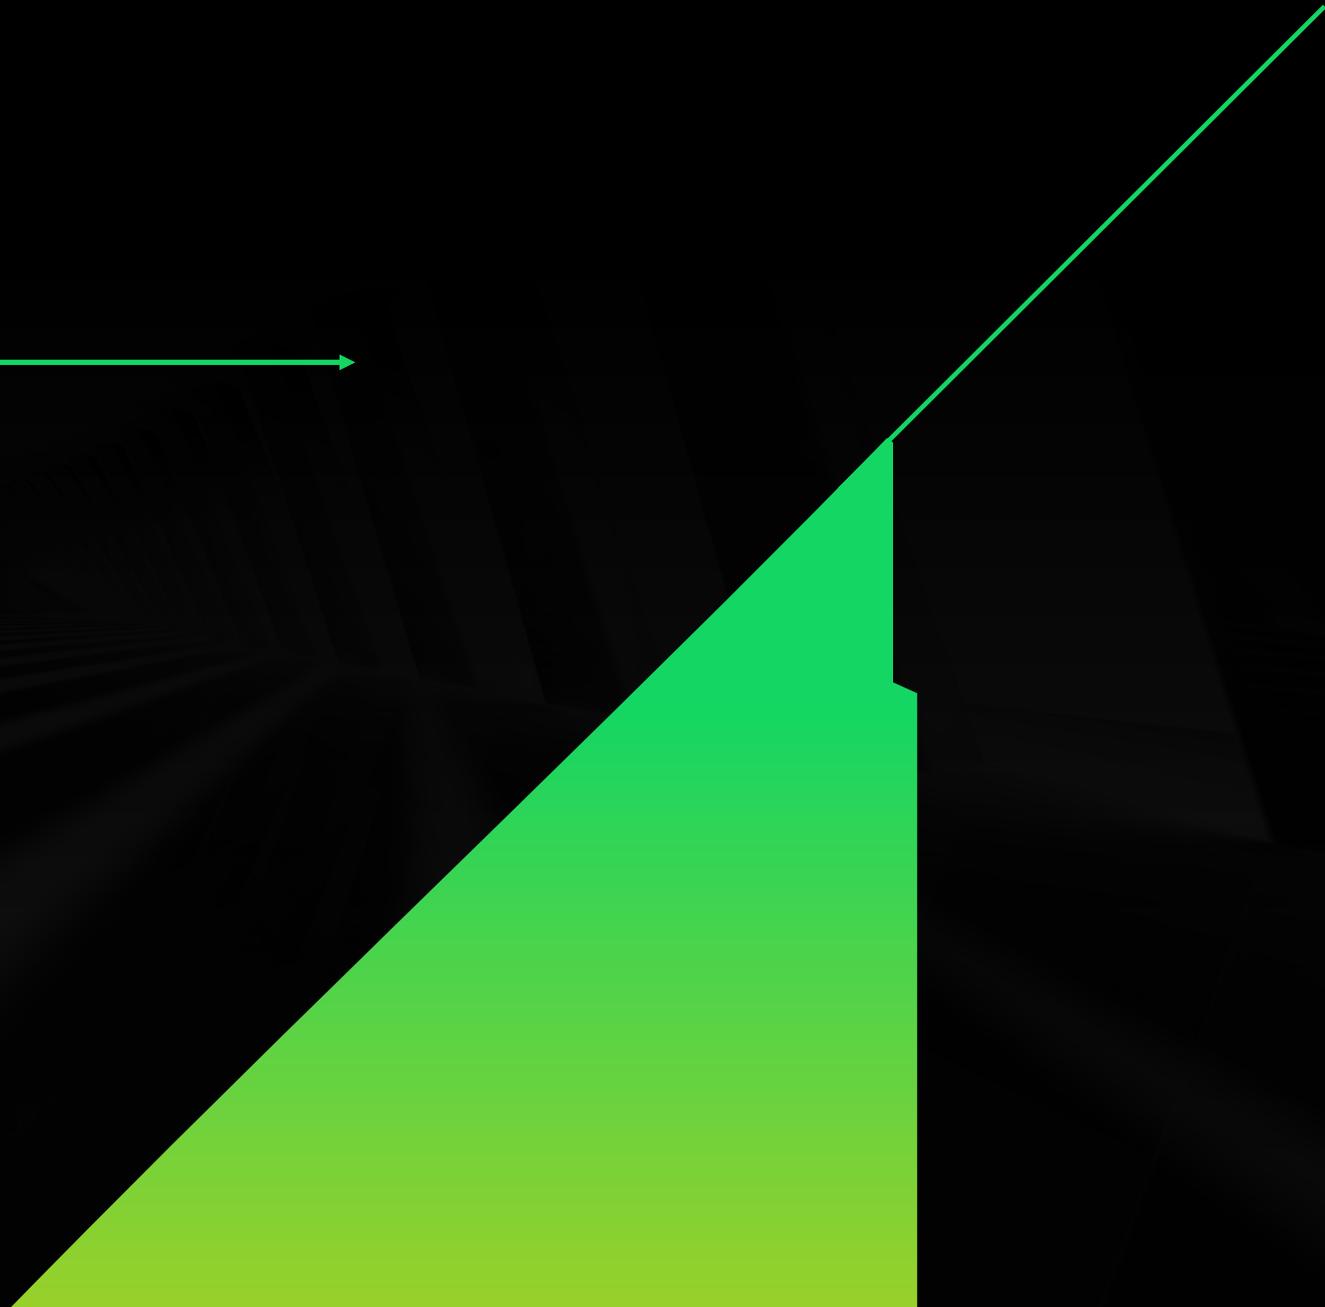

# 明确性

---

- 通用名称应清晰、准确、易于理解
- 避免使用容易引起误解或混淆的词汇
- 通用名称应与医疗器械的功能、用途、性能等相一致
- 通用名称应避免使用具有误导性的词汇，如“最新”、“最先进”等

# 唯一性

---

医疗器械通用名称应具有唯一性，避免与其他医疗器械名称混淆

医疗器械通用名称应简洁明了，易于识别和记忆

医疗器械通用名称应符合国际标准和规范，便于国际交流与合作

医疗器械通用名称应考虑医疗器械的用途、性能、结构等特点，便于使用者理解和选择

# 稳定性

命名应保持稳定性，避免频繁更改

命名应具有长期适用性，不受技术进步影响

命名应考虑产品的生命周期，确保长期有效

命名应避免使用容易引起误解或混淆的词汇

# 规范性

- 命名应符合国家法律法规和行业标准
- 命名应遵循科学、合理、准确、简洁的原则
- 命名应避免使用容易引起误解或歧义的词汇
- 命名应避免使用具有误导性或暗示性的词汇
- 命名应避免使用与已有医疗器械名称相似的词汇
- 命名应避免使用与已有药品名称相似的词汇
- 命名应避免使用与已有医疗器械通用名称相似的词汇
- 命名应避免使用与已有药品通用名称相似的词汇
- 命名应避免使用与已有医疗器械商品名称相似的词汇
- 命名应避免使用与已有药品商品名称相似的词汇
- 命名应避免使用与已有医疗器械注册商标相似的词汇
- 命名应避免使用与已有药品注册商标相似的词汇
- 命名应避免使用与已有医疗器械专利名称相似的词汇
- 命名应避免使用与已有药品专利名称相似的词汇
- 命名应避免使用与已有医疗器械技术标准名称相似的词汇
- 命名应避免使用与已有药品技术标准名称相似的词汇
- 命名应避免使用与已有医疗器械行业标准名称相似的词汇
- 命名应避免使用与已有药品行业标准名称相似的词汇
- 命名应避免使用与已有医疗器械国际标准名称相似的词汇
- 命名应避免使用与已有药品国际标准名称相似的词汇
- 命名应避免使用与已有医疗器械行业术语相似的词汇
- 命名应避免使用与已有药品行业术语相似的词汇
- 命名应避免使用与已有医疗器械专业术语相似的词汇
- 命名应避免使用与已有药品专业术语相似的词汇
- 命名应避免使用与已有医疗器械行业习惯用语相似的词汇

03



# 命名方法

章节副标题



# 依据产品特性命名

明确产品用途：根据产品的实际用途进行命名

突出产品特点：强调产品的独特性或优势

遵循行业规范：遵循医疗器械行业的命名规范和标准

避免误导消费者：避免使用容易引起误解或误导消费者的词汇

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/518131111047006057>